


แผนกรังสีวิทยา



อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี




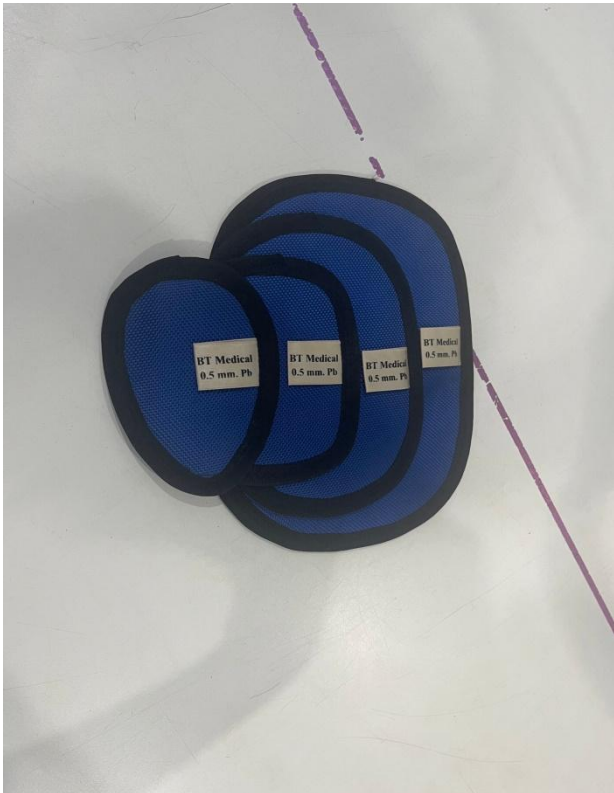


เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ลำดับ	รายการยา	จำนวน	วันที่	หมายเหตุ
1	ADRENALINE INJ 1mg/ml	30	01-23	
2	ATROPINE sulfate INJ 0.5mg/5ml	5	01-23	
3	amiodARONE INJ 150mg/3ml	3	10-23	
4	adenOSINE INJ 6mg/2ml	6	11-21*	
5	calcium GLUCONATE INJ 100mg/10ml	2	20-1-23	93flow
6	Diazepam INJ 10mg/2ml	2	15-10-23	
7	Digoxin INJ 0.5mg/2ml	2	10-21	
8	NORepinephrine INJ 4mg/4ml	2	10-21	
9	50% Glucose INJ 50g/100ml	2	20-1-23	
10	sodium BICARBONATE INJ 3.75g/50ml	2	20-1-23	
11	2% Lidocaine INJ 20ml	1	20-1-23	

ลงชื่อ..... ผู้รักษา วันที่ 10. 6. 23

ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

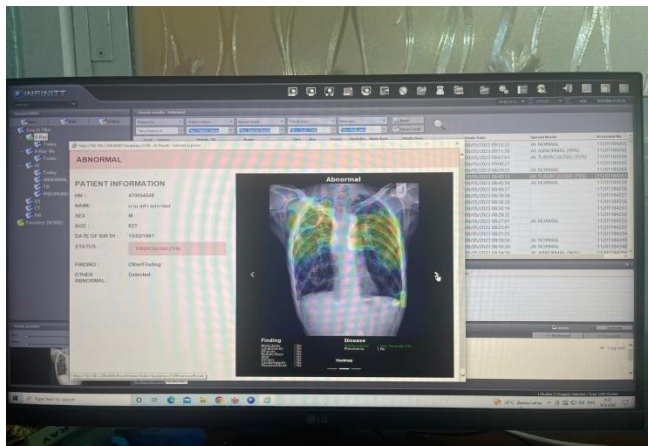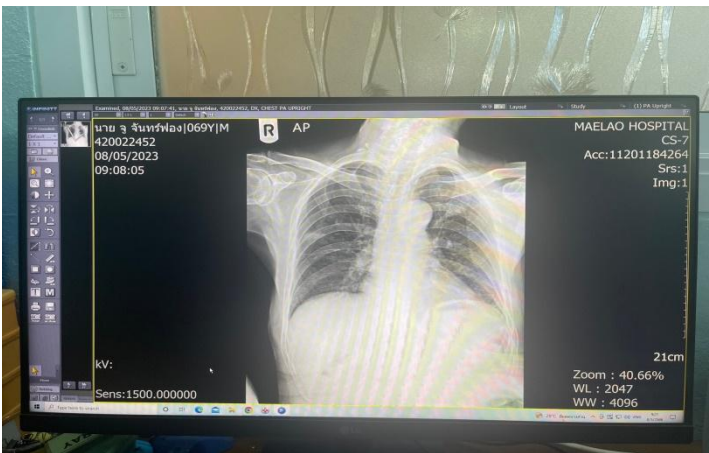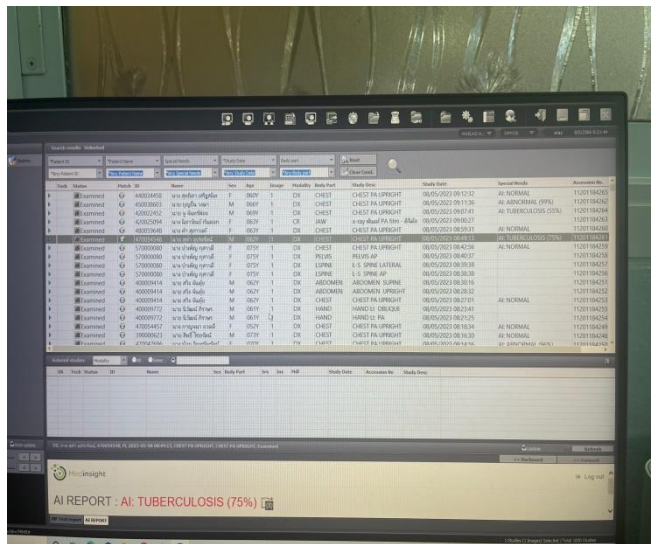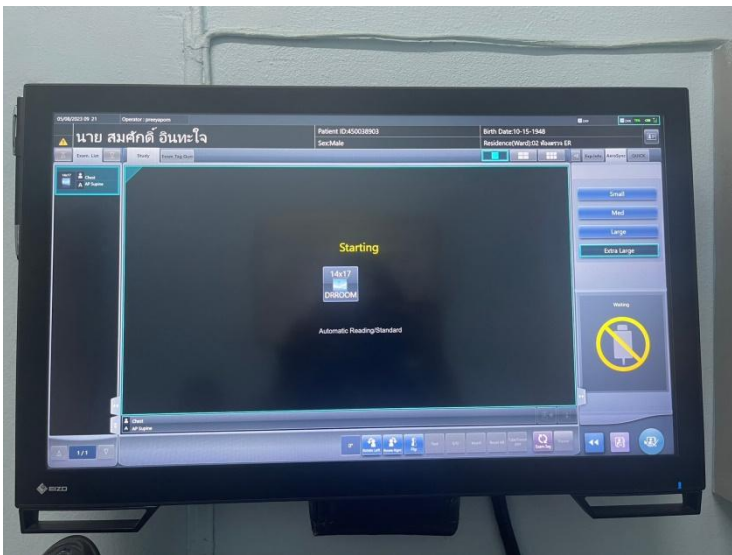

อุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล แบบ DR (Digital Radiography)



เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
(ใช้ร่วมกับ ER.)



ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะ
เครื่องเอกซเรย์ทำงาน