


5.10.2 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ทำให้กำเนิดรังสีจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

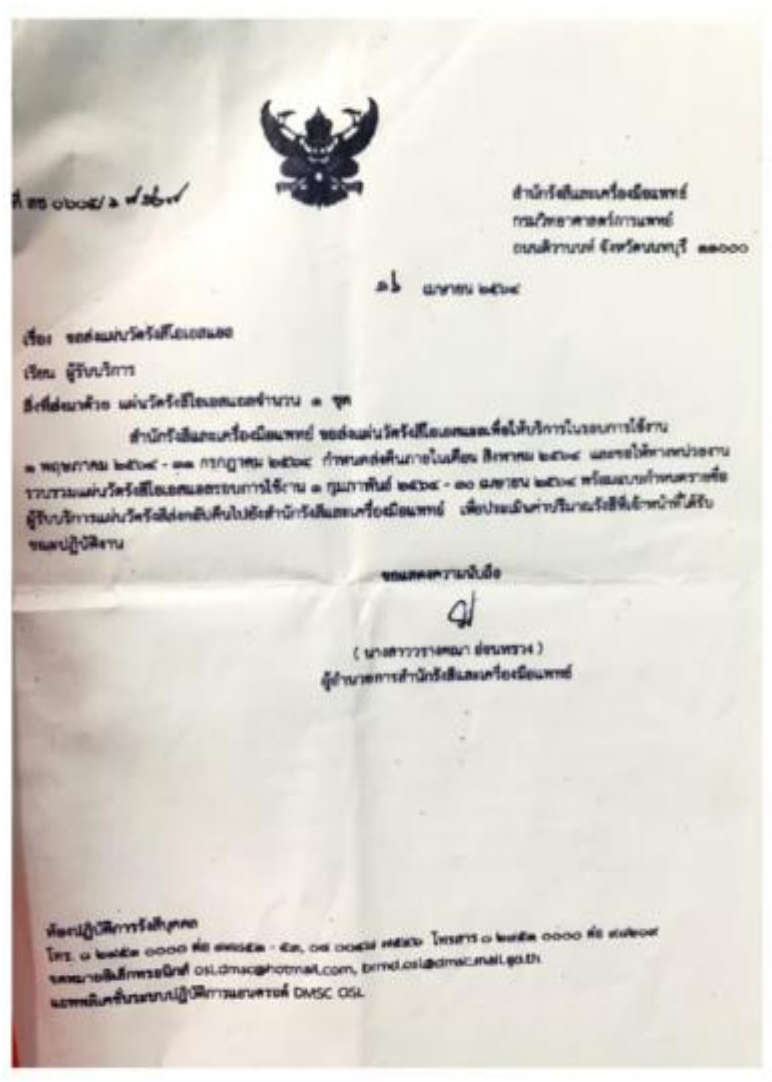

ใบแจ้งเครื่องเอกซเรย์
มาตรฐานการแพทย์
หมู่ที่ 4 ซ.วิภาวดีรังสิต 14 ต.จตุจักร อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0 2851 0000-10 ต่อ 99851-53 และ 08 0048 7546 โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ 98209

ได้การรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017
หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานปริมาณรังสีบุคคล (ต่อ)

สืบ-รายชื่อ	ปริมาณรังสี (ไมโครซีเวิร์ด)			ปี/เดือน ที่รับ	เลขวิเคราะห์	อวัยวะที่วัด	เกณฑ์
	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(3)				
2. กาญจนาพร เชื้อนาค	80	83	80	63/05 /	0463316159	ลำตัว	S
3. กาญจนาพร เชื้อนาค	80	83	80	63/08 ๐	0463316160	ลำตัว	S
4. กาญจนาพร เชื้อนาค	80	83	80	63/07	0463316161	ลำตัว	S
ศิริอารณ์ ยาศรี	77	77	77	63/05 /	0463316162	ลำตัว	S
ศิริอารณ์ ยาศรี	77	77	77	63/08 ๐	0463316163	ลำตัว	S
ศิริอารณ์ ยาศรี	77	77	77	63/07	0463316164	ลำตัว	S
ศิริอารณ์ ยาศรี	77	77	77	63/05 /	0463316165	ลำตัว	S
สมศรี เสงี่ยม	63	63	63	63/06 ๐	0463316166	ลำตัว	S
สมศรี เสงี่ยม	63	63	63	63/07	0463316167	ลำตัว	S
สมศักดิ์ ชัยวงศ์	133	143	143	63/05 /	0463316168	ลำตัว	S
สมศักดิ์ ชัยวงศ์	133	143	143	63/08 ๐	0463316169	ลำตัว	S
สมศักดิ์ ชัยวงศ์	133	143	143	63/07	0463316170	ลำตัว	S

ผู้ประเมินผล (นายเดวิด ดุงคะเสร์ริท) นักฟิสิกส์รังสี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ (นายประพัฒน์ ฉากเจริญกิจ) นักฟิสิกส์รังสี หน่วยงานการพิเศษ